

# 行政院原子能委員會 函

機關地址：23452 台北縣永和市成功路 1 段 80 號 2 樓

承辦人：范盛慧

連絡電話：(02)22322149

傳真：(02) 8231-7830

E-Mail：shfan@aec.gov.tw

10476

台北市中山區復興北路 420 號 10F

受文者：中華民國牙醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國 98 年 11 月 6 日

發文字號：會輻字第 0980018742 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：操作範例乙份

主旨：為提升輻射防護管制效能，請 貴會協助轉知所屬會員，診所歇業或停業時，務必向本會辦理 X 光機停用或永久停用手續，以免觸法，請 查照。

說明：

- 一、依據「游離輻射防護法」第 35 條及「放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法」第 35、38、39、40 條規定，X 光機停止使用時，應向本會辦理停用或永久停用手續。另依「游離輻射防護法」第 43 條第 6 款規定，未依規定處理 X 光機，處新台幣 10 萬元以上 50 萬元以下罰鍰。
- 二、前述手續可於本會網站（[www.aec.gov.tw](http://www.aec.gov.tw)）線上服務辦理，操作程序（以永久停用為例）如附件所示。
- 三、有關 X 光機使用、遷移、資料異動、停用及永久停用等線上申辦相關事宜，請洽本案承辦人范盛慧技正（聯絡電話：02-2232-2149）。


正本：中華民國牙醫師公會全國聯合會（104 台北市復興北路 420 號 10 樓）

副本：本會輻射防護處


主任委員 蔡春鴻

## 牙科型 X 光機永久停用(報廢)操作範例 (V981105)


### 1. 進入原子能委員會首頁(http://www.aec.gov.tw)。

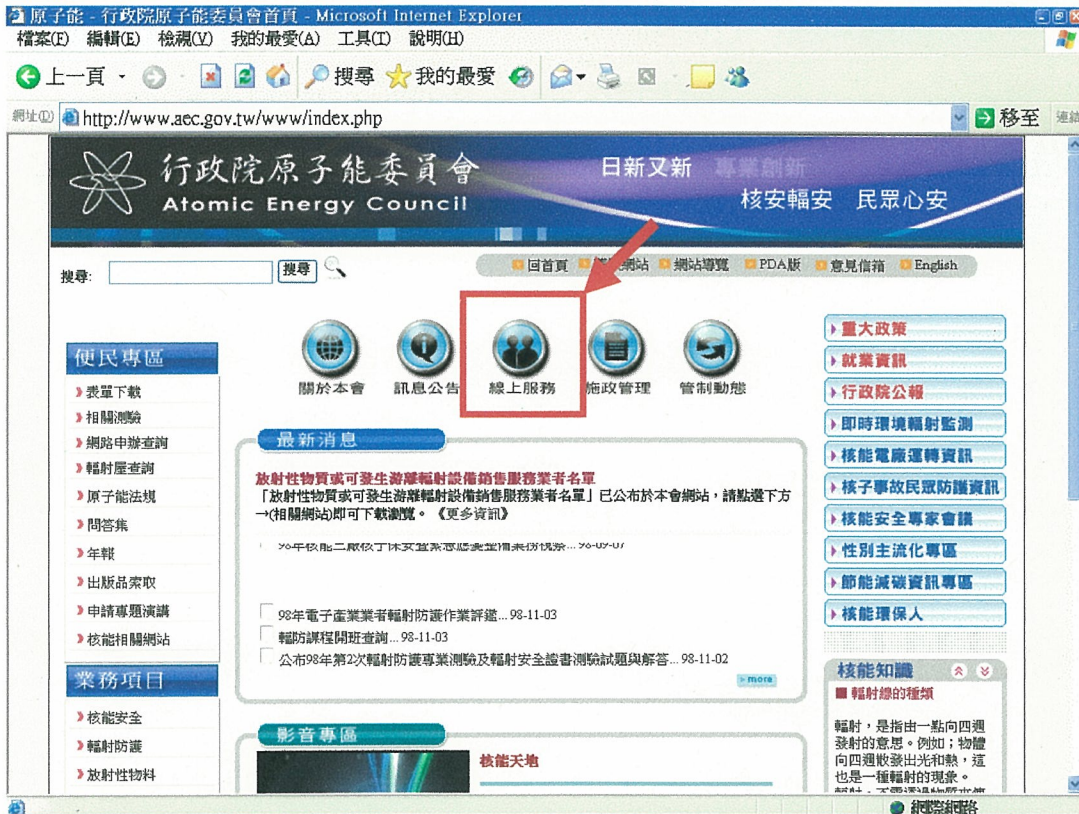


### 2. 點選「線上服務」選單下之「輻防管制線上申請及查詢」。

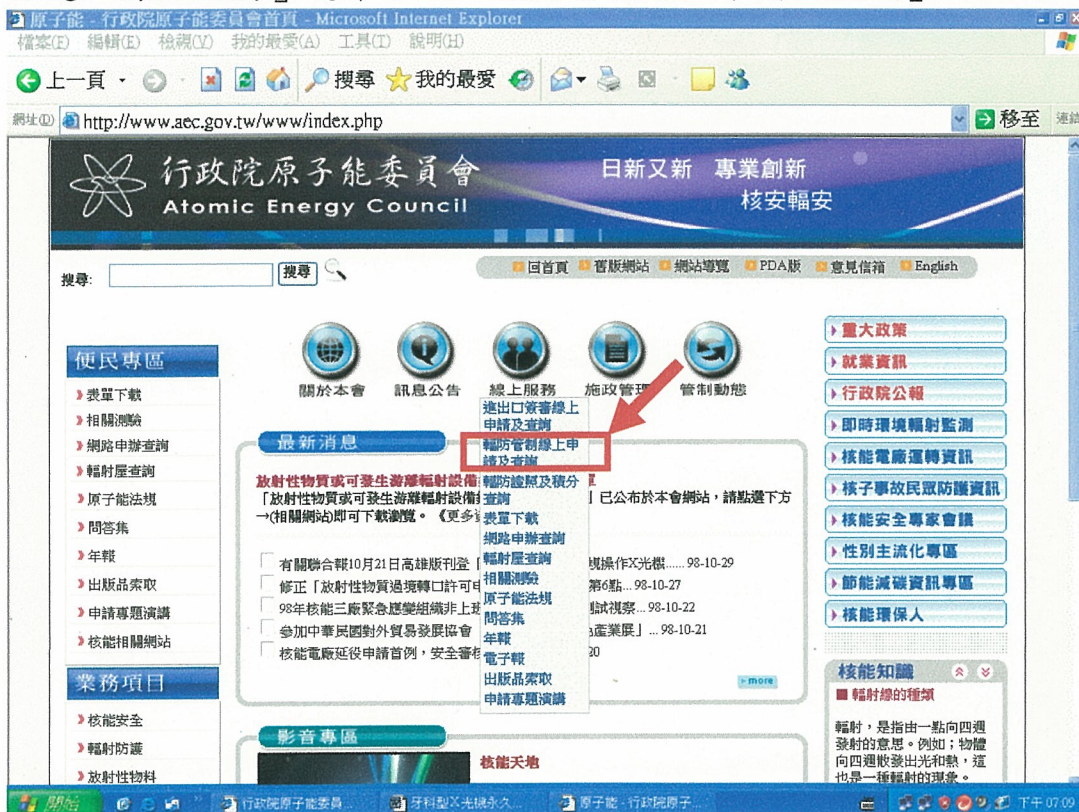


### 3. 點選「輻射防護管制線上申請」。

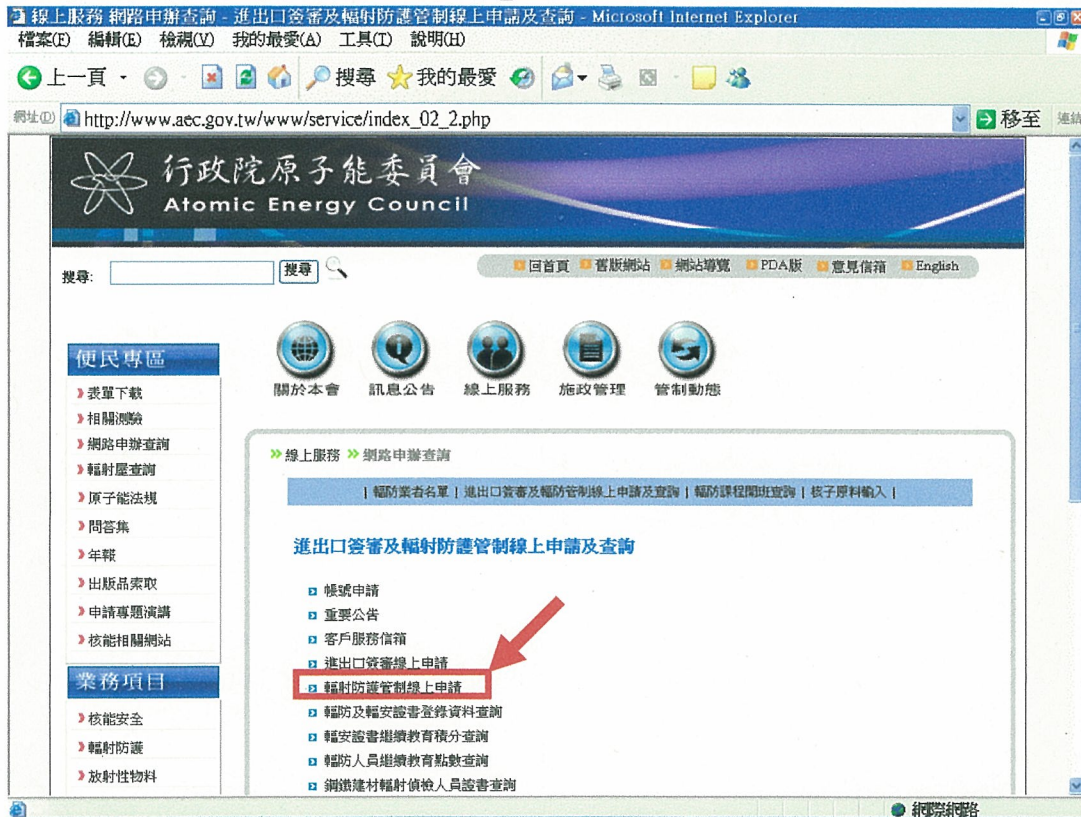


### 4. 進入登入首頁，登打「帳號」及「密碼」後，按「確定」，登入系統。

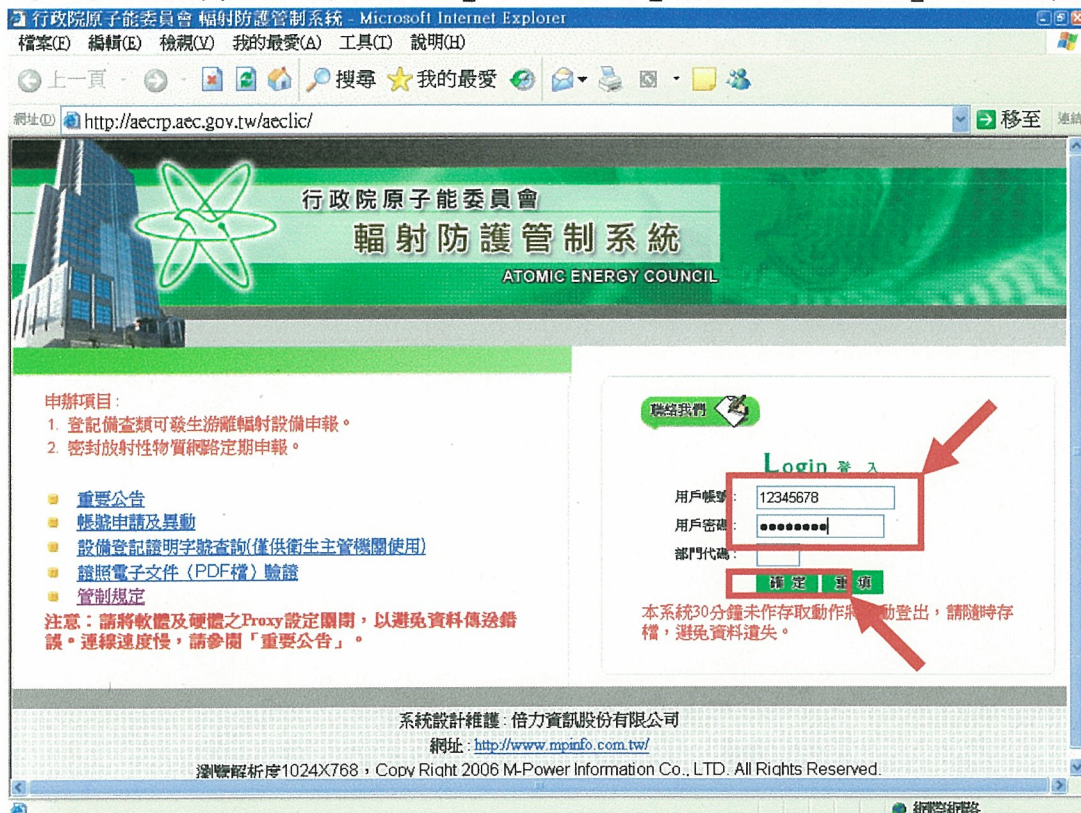

5. 讀完「教示宣告」，確定已遵守並符合法規規定後，按下網頁下方之「同意」按鈕，進入申辦網頁。

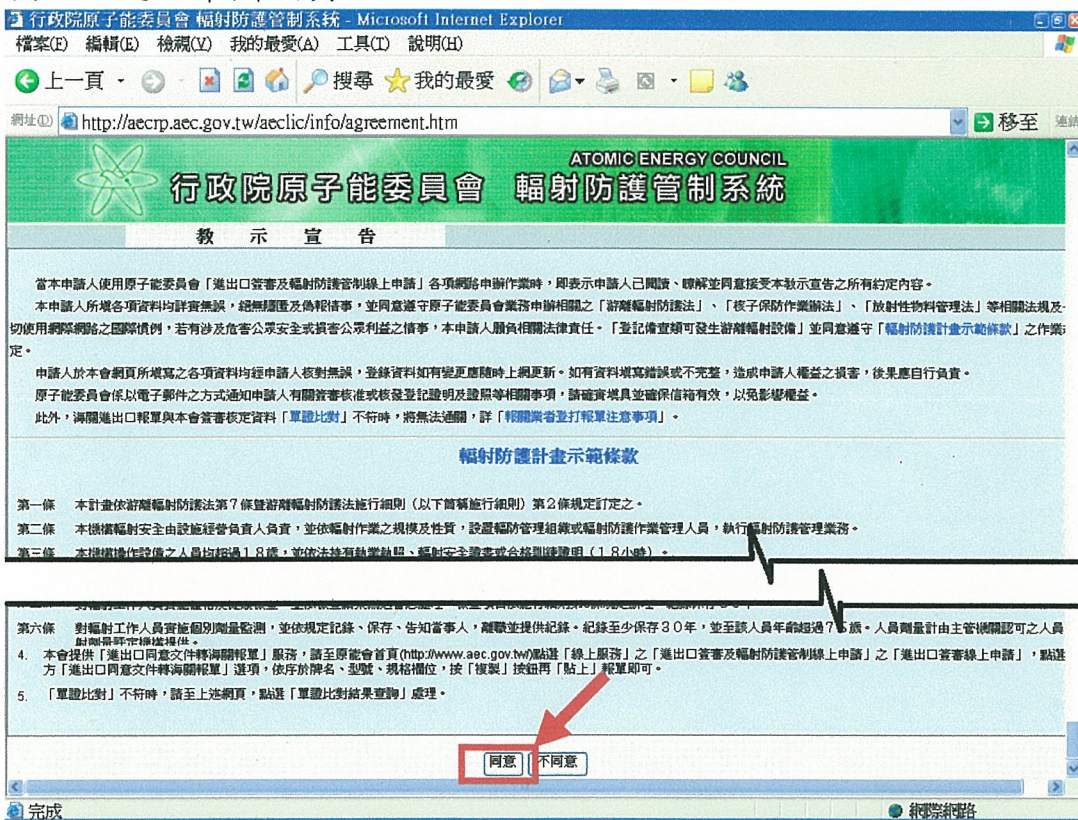

6. 點選「登記備查設備申報」選單下之「永久停用(含原能會廢止)」。

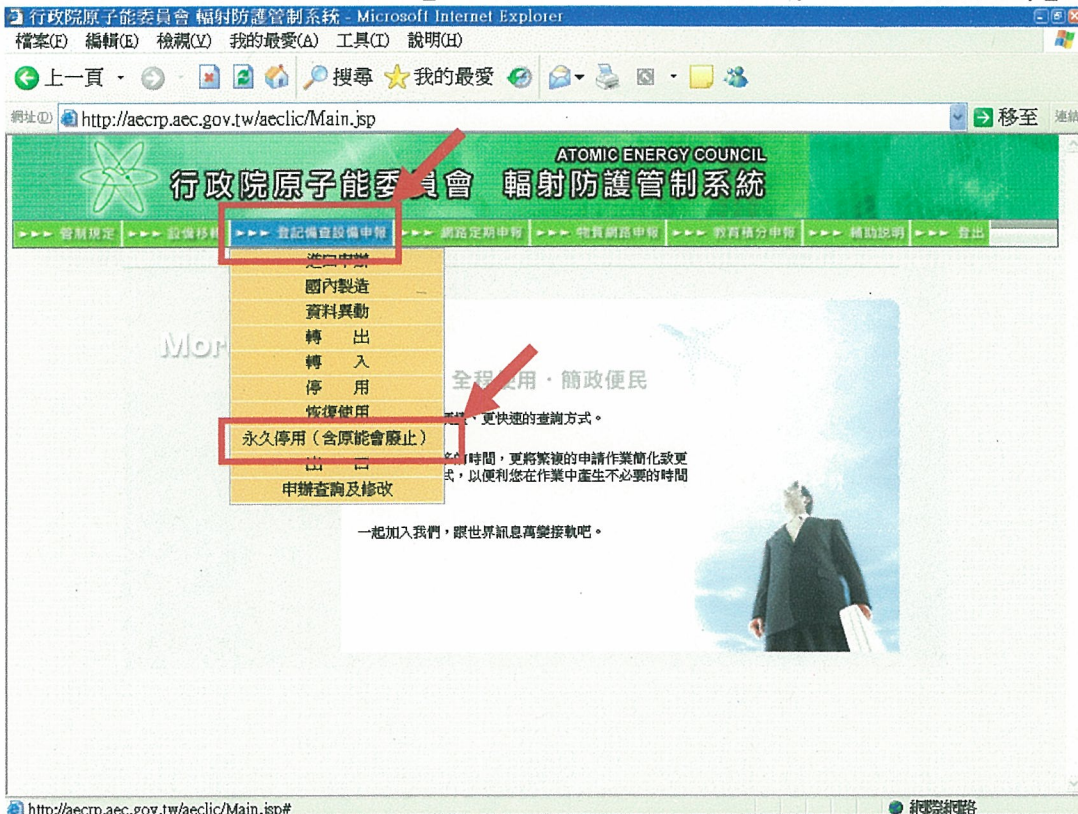

## 7. 按「查詢」列出所持有之牙科型X光機清單。

行政院原子能委員會 輻射防護管制系統 - Microsoft Internet Explorer

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

← 上一頁 · 搜尋 ☆ 我的最愛

網址(1) http://aecrp.aec.gov.tw/aeclic/LICREG004-01.jsp?CHGTYPE=H 移至 連結

ATOMIC ENERGY COUNCIL  
行政院原子能委員會 輻射防護管制系統

管制規定 >>> 設備移轉 >>> 登記備置設備申報 >>> 網路定期申報 >>> 物質網路申報 >>> 教育積分申報 >>> 輔助說明 >>> 登出

設備—永久停用(含原能會廢止)  
(LICREG004)

|        |                                                                                                                                                                                                              |        |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 類別     | 03 登記備置設備                                                                                                                                                                                                    | 貨品分類號別 |  |
| 申請文號   |                                                                                                                                                                                                              | 登記證明字號 |  |
| 審查收文號  |                                                                                                                                                                                                              | 審查核准文號 |  |
| 設備廠牌   |                                                                                                                                                                                                              | 設備型號   |  |
| 申請期間起迄 | <input type="text"/> - <input type="text"/>                                                                                                                                                                  |        |  |
| 排序     | <input type="radio"/> 申請日期 <input type="radio"/> 發證日期 <input type="radio"/> 有效日期 <input type="radio"/> 審查收文號 <input type="radio"/> 申請文號 <input type="radio"/> 登記證明字號 <input type="radio"/> 設備類別 (第二級以申請日期排序) |        |  |

查詢

完成 網際網路

## 8. 點選前方選取圓圈，再按下方「異動」，按鈕開始申辦。

行政院原子能委員會 輻射防護管制系統 - Microsoft Internet Explorer

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

← 上一頁 · 搜尋 ☆ 我的最愛

網址(1) http://aecrp.aec.gov.tw/aeclic/LICREG004-01.jsp 移至 連結

ATOMIC ENERGY COUNCIL  
行政院原子能委員會 輻射防護管制系統

管制規定 >>> 設備移轉 >>> 登記備置設備申報 >>> 網路定期申報 >>> 物質網路申報 >>> 教育積分申報 >>> 輔助說明 >>> 登出

設備—永久停用(含原能會廢止)  
(LICREG004)

|        |                                                                                                                                                                                                              |        |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 類別     | 03 登記備置設備                                                                                                                                                                                                    | 貨品分類號別 |  |
| 申請文號   |                                                                                                                                                                                                              | 登記證明字號 |  |
| 審查收文號  |                                                                                                                                                                                                              | 審查核准文號 |  |
| 設備廠牌   |                                                                                                                                                                                                              | 設備型號   |  |
| 申請期間起迄 | <input type="text"/> - <input type="text"/>                                                                                                                                                                  |        |  |
| 排序     | <input type="radio"/> 申請日期 <input type="radio"/> 發證日期 <input type="radio"/> 有效日期 <input type="radio"/> 審查收文號 <input type="radio"/> 申請文號 <input type="radio"/> 登記證明字號 <input type="radio"/> 設備類別 (第二級以申請日期排序) |        |  |

查詢

| 選取                                  | 申請文號      | 審查核准文號         | 申請文號        | 登記證明字號          | 設備類別    | 貨物名稱                                    | 設備廠牌 | 設備型號     | 上一次具動類別 | 原證照號碼       | 申請日期           | 發證日期           | 有效日期           | 保管部門 |
|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----------------|---------|-----------------------------------------|------|----------|---------|-------------|----------------|----------------|----------------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 96Z000048 | AE096000000482 | 096N0001314 | 登記字<br>1018952號 | 電腦斷層掃描機 | dfvbedfmbafbjk<br>vbfdbdfbdfb vbfvbfdfn | Acer | SP123500 | 進口申辦    | 096N0001314 | 096年03<br>月10日 | 096年03<br>月10日 | 103年03<br>月09日 |      |

1

異動

完成 網際網路

## 9. 檢查系統帶出之資料是否正確，如有錯誤，敬請修正。

行政院原子能委員會 輻射防護管制系統 - Microsoft Internet Explorer

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

← 上一頁 · 搜尋 ☆ 我的最愛

網址: http://aecrp.aec.gov.tw/aeclic/LICREG004-02.jsp

**行政院原子能委員會 輻射防護管制系統**

管制規定 · 設備移轉 · 登記備查設備申報 · 網路定期申報 · 物資網路申報 · 教育積分申報 · 輔助說明 · 登出

**設備—永久停用 (含原能會廢止)**  
(LICREG004)

設備異動 測試報告

存檔 邏輯檢查 傳送 申請資料列印 登記備查證明文件列印 複製 複製請填寫申請文號:

**有符合者為必填，點選邏輯檢查時會顯示錯誤訊息。**  
**簽審及通關基本資料 (由進出口簽審資料自動帶入，不得更改)**

|        |                          |        |                |
|--------|--------------------------|--------|----------------|
| 簽審收文號  | 0962000048               | 簽審核准文號 | AE096000000482 |
| 受理單位代號 | 1                        | 進出口別   | 進口             |
| 申請日期   |                          | 報單日期   |                |
| 生產國別   | United States of America | 申請人識別碼 | 10000009       |
| 申請人名稱  | 原能第一有限公司 (一廠一證)          |        |                |
| 申請人地址  | 台北市承德路一段100號             |        |                |

**帳號及基本資料 重新讀取帳號基本資料 (除「使用場所」外，其他資料由帳號資料自動帶入，不得更改，如需修正請作帳號異動)**

|         |                 |       |                        |
|---------|-----------------|-------|------------------------|
| 單位編號    | test0001        | 單位名稱  | 原能第一科技股份有限公司台北分公司 (tes |
| 保管部門    | 部門編號:           | 部門名稱: |                        |
| 單位地址    | 郵遞區號: 100       | 地址:   | 台北市基隆路一段1000號          |
| 單位email | rpms@aec.gov.tw |       |                        |
| 單位電話    | 01-11111111     | 連絡人   | 劉一一                    |

完成

## 10. 下拉捲軸，將網頁畫面向下捲動，點選「規費：免繳交」，「測試報告：免填寫」，再按「確定」按鈕。

行政院原子能委員會 輻射防護管制系統 - Microsoft Internet Explorer

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

← 上一頁 · 搜尋 ☆ 我的最愛

網址: http://aecrp.aec.gov.tw/aeclic/LICREG004-02.jsp

停用截止日期 最近登記備查日期 098年03月10日

出(受)讓單位編號 銷售服務業單位編號

出(受)讓單位名稱

**審查意見**

本案承辦人 本案承辦人電話

**明細資料**

|        |                                     |         |          |
|--------|-------------------------------------|---------|----------|
| 貨物名稱   | dfvbsdfmbfjkb vbfdbfbdffb vbfvbsdfn |         |          |
| 貨品分類碼列 | 90189040103                         | 進出口商品類別 | 登記備查設備   |
| 設備廠牌   | Acer                                | 設備型號    | SP123500 |
| 管電壓能量  | 70.0000                             | 管電壓單位   | kVp      |
| 申請數量   | 1                                   | 申請數量單位  | 台        |
| 申報數量   | 1                                   |         |          |
| 設備序號   | 123                                 |         |          |

**規費** ☒ 免繳交 ☐ 須繳交

規費類別

繳費方式 金額 0

**測試報告** ☒ 免填寫 ☐ 須填寫

業者備註

**確定**

完成


11. 按「邏輯檢查」按鈕，確認資料都填寫正確，如有錯誤，請依指示修正。  
如顯示「邏輯檢查通過」，請按「確定」按鈕。

The screenshot shows the '行政院原子能委員會 輻射防護管制系統' (Atomic Energy Council Radiation Protection Management System) interface. A modal dialog box titled '邏輯檢查通過!' (Logical Check Passed!) is displayed in the center. The dialog contains the text: '資料尚未傳送本會，檢查無誤，請按「傳送」按鈕，以完成申請程序。' (Data has not yet been sent to the Commission, check is correct, please click the 'Send' button to complete the application process.) Below the text are two buttons: '確定' (OK) and '取消' (Cancel). The '確定' button is highlighted with a red rectangle. In the background, the '設備異動' (Equipment Change) section is visible, with the '邏輯檢查' (Logical Check) button also highlighted with a red rectangle. The form fields show details for a device (test0001) and the user (test0001).


12. 「邏輯檢查通過」，請按「傳送」按鈕，顯示法令提示，閱讀完畢後，請按「確定」按鈕。

The screenshot shows the same system interface as the previous one, but now a modal dialog box titled 'Microsoft Internet Explorer' is displayed. The dialog contains a question mark icon and the text: '本設備係行政院原子能委員會依法列管項目，請確實申報，本會在此特別提醒，貴單位若未完成安裝及測試，請勿申請，若經查獲，無論是故意或無意，悉依相關主管機關法令處分(刑責、罰鍰及罰款)，並須負嚴重法律責任。' (This equipment is a project managed by the Atomic Energy Council of the Executive Yuan in accordance with the law. Please report it accurately. The Commission hereby特别提醒, if your unit has not completed installation and testing, do not apply. If caught, whether intentional or unintentional, it will be dealt with according to relevant laws (criminal liability, fines, and penalties), and you must bear serious legal responsibility.) Below the text are two buttons: '確定' (OK) and '取消' (Cancel). The '確定' button is highlighted with a red rectangle. In the background, the '設備異動' (Equipment Change) section is visible, with the '傳送' (Send) button also highlighted with a red rectangle. The form fields show details for a device (test0001) and the user (test0001).

## 13. 顯示「傳送成功」，請按「確定」按鈕。

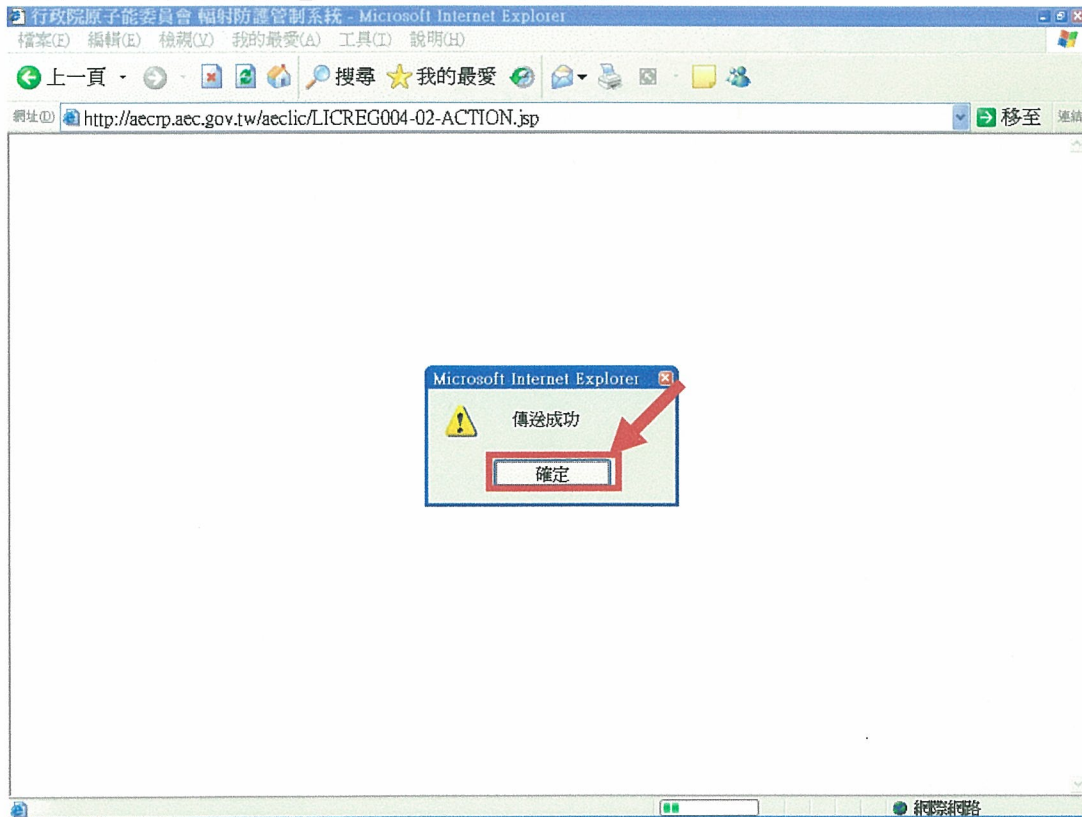

## 14. 按「登出」，回到登入首頁，完成申辦。

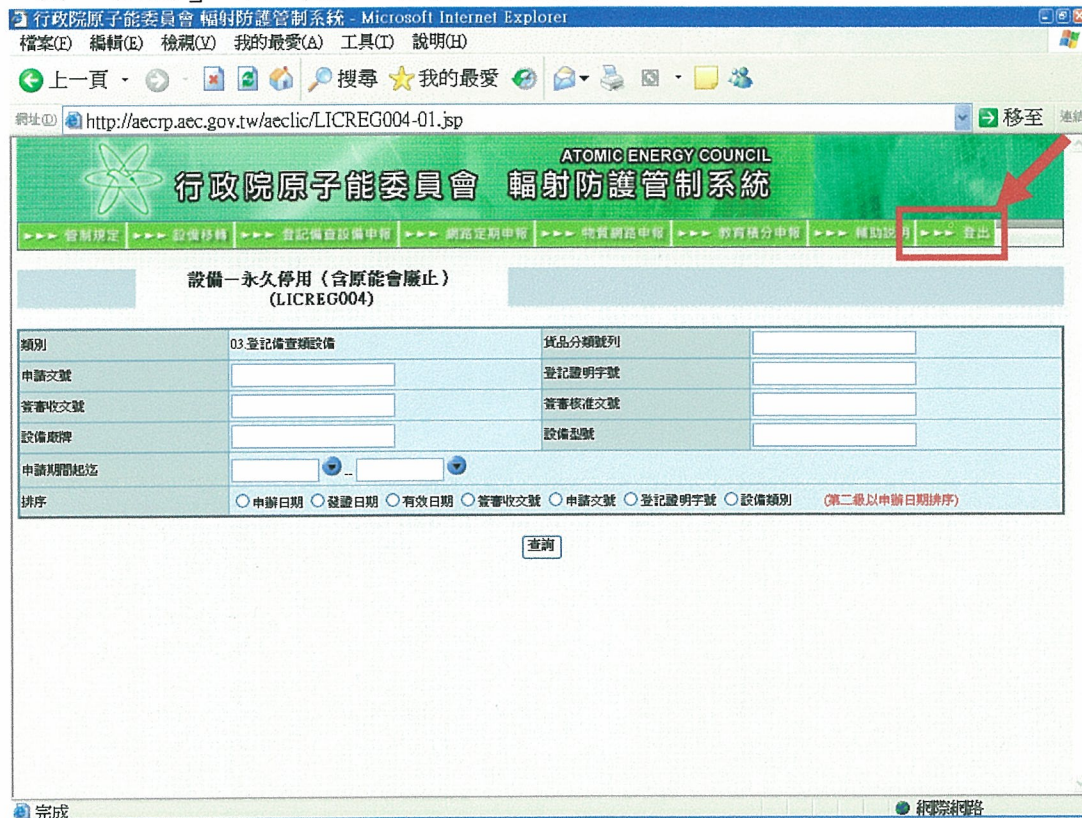

## 15. 如有其他申辦問題，請撥原子能委員會輻射防護處醫用科客戶服務專線：(02)2232-2193、(02)2232-2194，謝謝您的協助。